







11. Die Hörgeräteanpassung erfolgt unter Berücksichtigung aller wesentlichen Mess- und Anpassdaten sowie des individuellen Hörempfindens.


Nutzschall	65dB	(min 20%-Punkte)	(min 10%-Punkte)
Störschall	-		
ohne Hörsysteme	50 %		30 %
mit Hörsystemen	90 %		50 , 0 %
Hörgewinn	40 %		20 , 0 %

	ohne Hörsysteme mit Hörsystemen Hörgewinn	
65dB	(min 20%-Punkte)	(min 10%-Punkte)
	%	%
	%	%
	%	%
60dB		



a) beidseitige Versorgung

10. Freifeldmessungen (65 dB, 1 m Abstand) DIN 45621

Versorgung über LL: R  L  bds  über KL: R  L  bds 

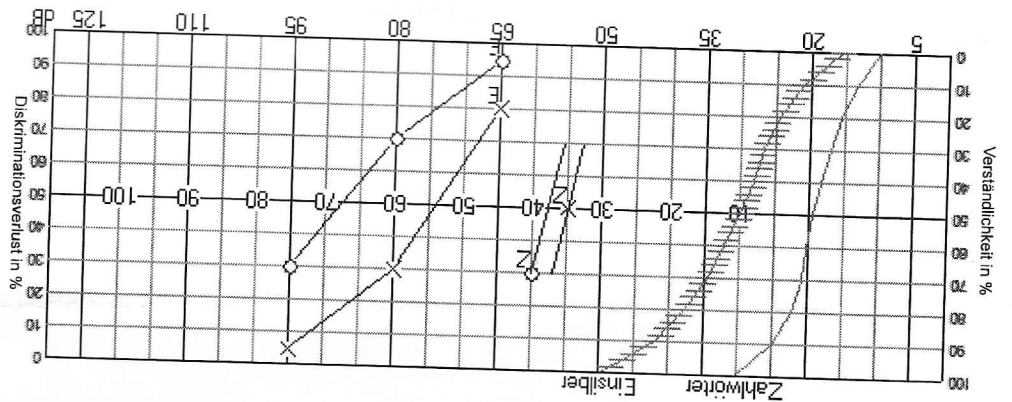

9. Sprachtest nach DIN 45621 (gemäß DIN ISO 8253-3 12 u. 13)

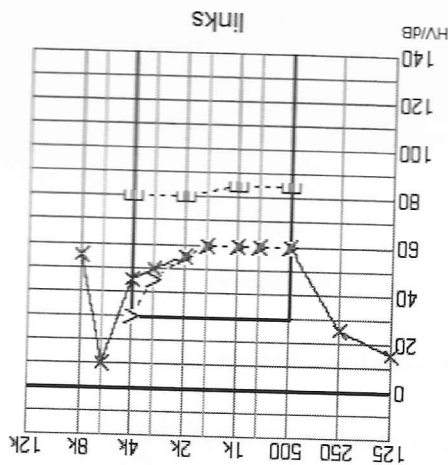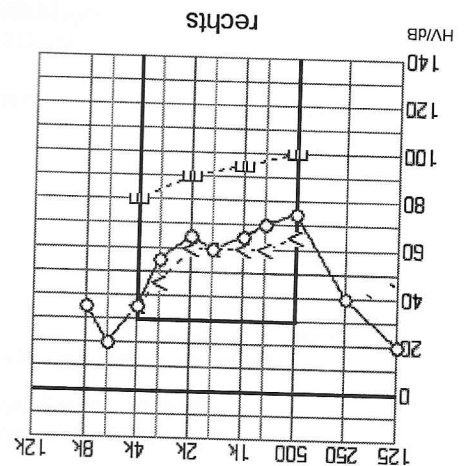

Luftleitung:
rechts: ○-○
links: X-X
U-Grenze: IIII
Verabung: ■

Knochenleitung:
rechts: <---<
links: >--->
Verabung: WWW